

Resultate


Vor Saugexperiment

Nach Saugexperiment

Effizienz

Messgrösse		
Gesamtmenge Lactose	247.5 g	
Partikelgrösse	2.25 % < 1.0 µm	9.84 % < 2.0 µm
Nicht abgeschiedene Lactose	< 10 mg	
Partikelgrösse in Filter Queen	2.51 % < 1.0 µm	10.4 % < 2.0 µm
Abscheidungsgrad	> 99.6 %	

Saugeffizienz

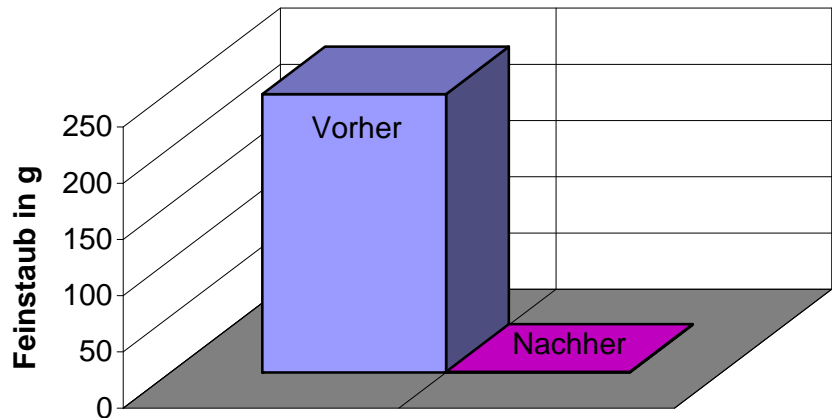

Beurteilung: Der Abscheidungsgrad erfüllt mindestens die Bedingungen der Filterklasse HEPA H12 (EN 1822-1). Der tatsächliche Abscheidungsgrad kann besser sein. Die verwendete Testanordnung kann das aber nicht messen.

Analysen durchgeführt: M. Kern

Studienleiter: A. Tognucci

M. Kern
Datum: 17.03.03

A. Tognucci
Datum: 17.03.2003